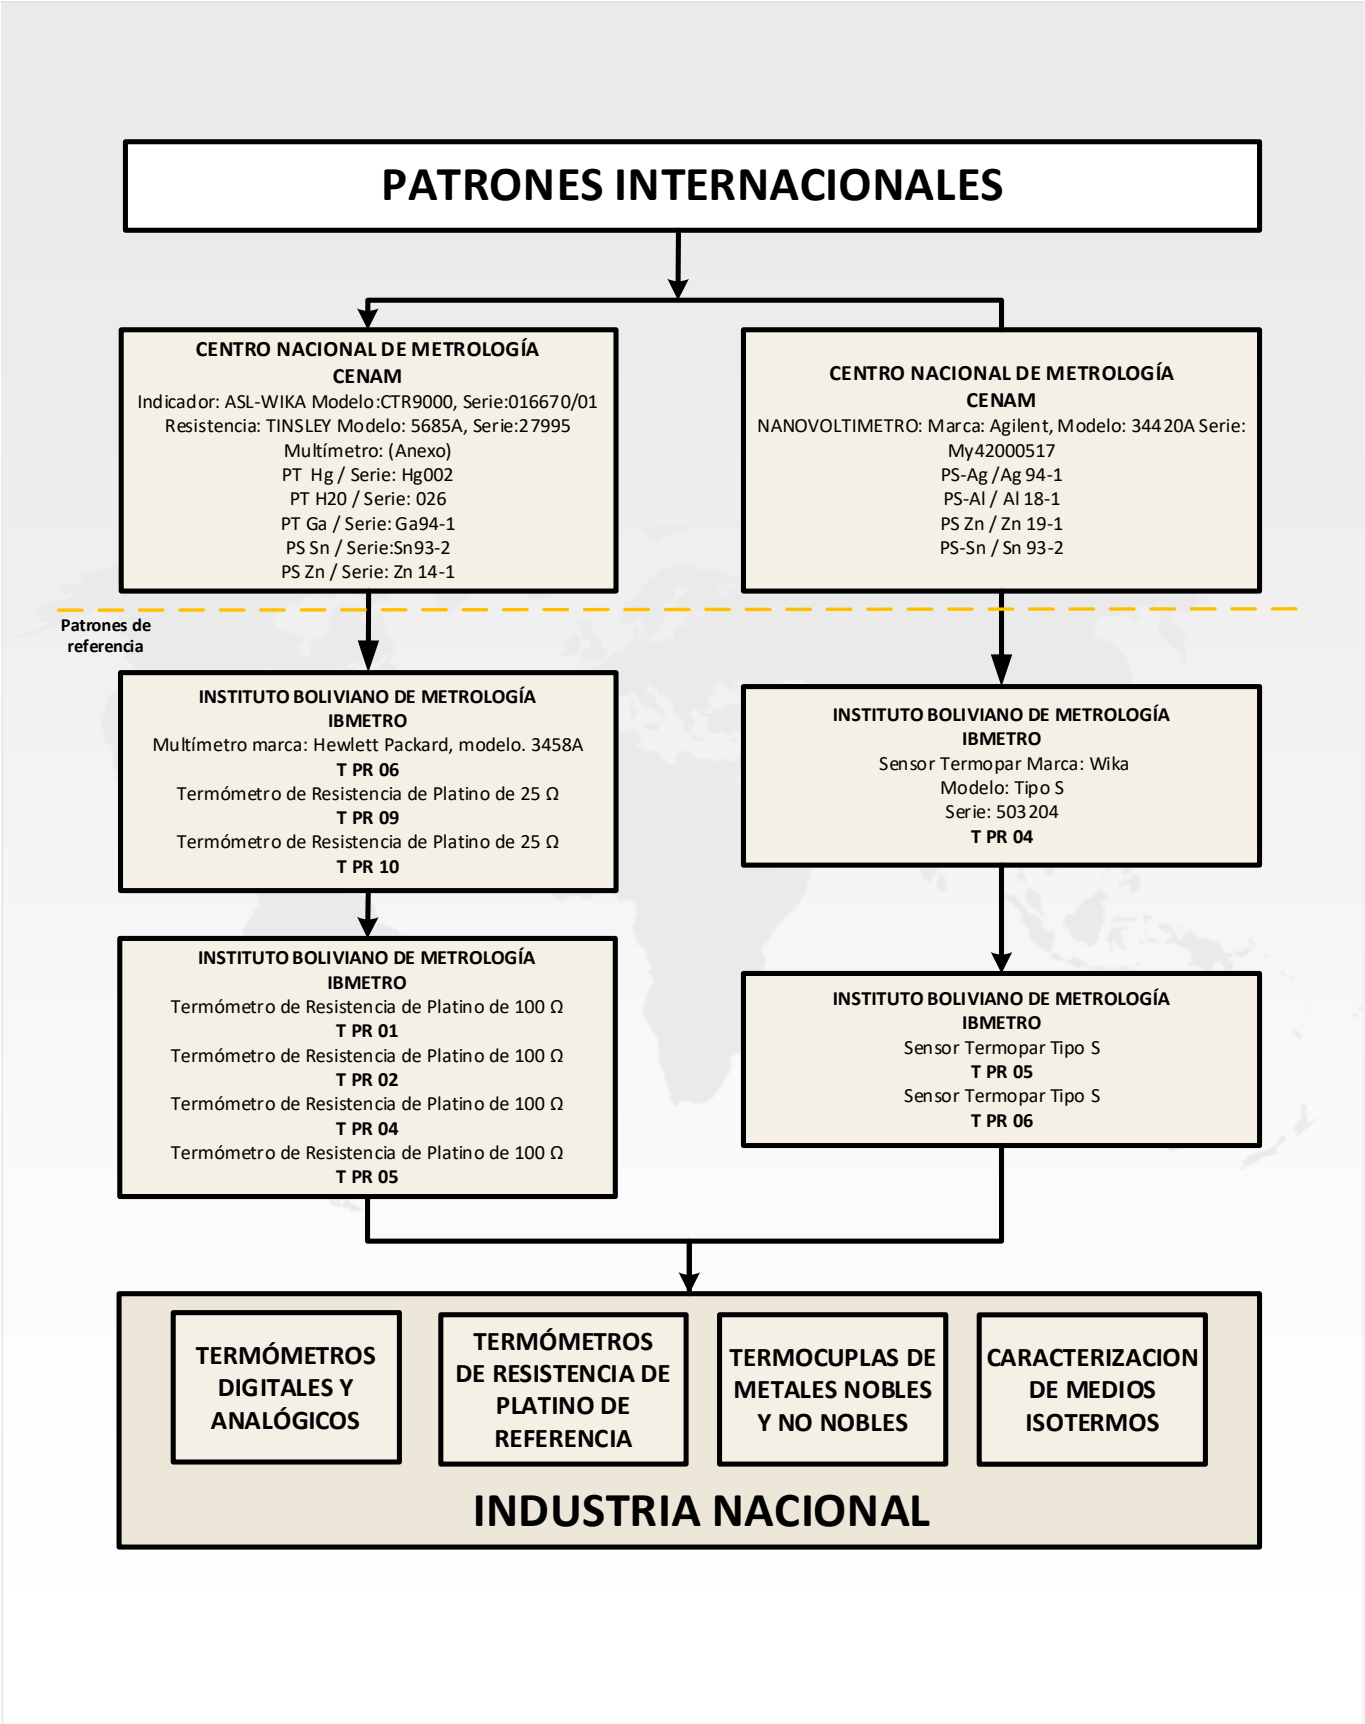
PATRONES INTERNACIONALES
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
CENAM
Indicador: ASL-WIKA Modelo:CTR9000, Serie:016670/01
Resistencia: TINSLEY Modelo: 5685A, Serie:27995
Multímetro: (Anexo)
PT Hg / Serie: Hg002
PT H20 / Serie: 026
PT Ga / Serie: Ga94-1
PS Sn / Serie:Sn93-2
PS Zn / Serie: Zn 14-1
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
CENAM
NANOVOLTIMETRO: Marca: Agilent, Modelo: 34420A Serie: My42000517
PS-Ag /Ag 94-1
PS-Al / Al 18-1
PS Zn / Zn 19-1
PS-Sn / Sn 93-2
Patrones de referencia
INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA
IBMETRO
Multímetro marca: Hewlett Packard, modelo. 3458A
T PR 06
Termómetro de Resistencia de Platino de 25 Ω
T PR 09
Termómetro de Resistencia de Platino de 25 Ω
T PR 10
INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA
IBMETRO
Sensor Termopar Marca: Wika
Modelo: Tipo S
Serie: 503204
T PR 04
INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA
IBMETRO
Termómetro de Resistencia de Platino de 100 Ω
T PR 01
Termómetro de Resistencia de Platino de 100 Ω
T PR 02
Termómetro de Resistencia de Platino de 100 Ω
T PR 04
Termómetro de Resistencia de Platino de 100 Ω
T PR 05
INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA
IBMETRO
Sensor Termopar Tipo S
T PR 05
Sensor Termopar Tipo S
T PR 06
TERMÓMETROS DIGITALES Y ANALÓGICOS
TERMÓMETROS DE RESISTENCIA DE PLATINO DE REFERENCIA
TERMOCUPLAS DE METALES NOBLES Y NO NOBLES
CARACTERIZACION DE MEDIOS ISOTERMOS
INDUSTRIA NACIONAL